


Таблица измерения пациента для изготовления реабилитационного тренажера ЭкзоБот



ЭКЗО-ТЕХНОЛОГИИ
СВЕРХСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ

Замеры произвел:	Пациент:		
Организация _____	Ф.И.О. _____		
Ф.И.О. _____	_____		
_____	Адрес проживания _____		
Должность _____	_____		
Адрес _____	Телефон _____		
_____	E-mail _____		
Телефон _____	Контактное лицо _____		
E-mail _____	Рост _____		
Дата замеров _____	Вес _____		
Примечание _____	Размер обуви _____		
_____		правая сторона	левая сторона
_____	Измерение 1	_____ см	_____ см
_____	Измерение 2	_____ см	_____ см
_____	Измерение 3	_____ см	_____ см
_____	Измерение 4	_____ см	

Правая сторона Левая сторона

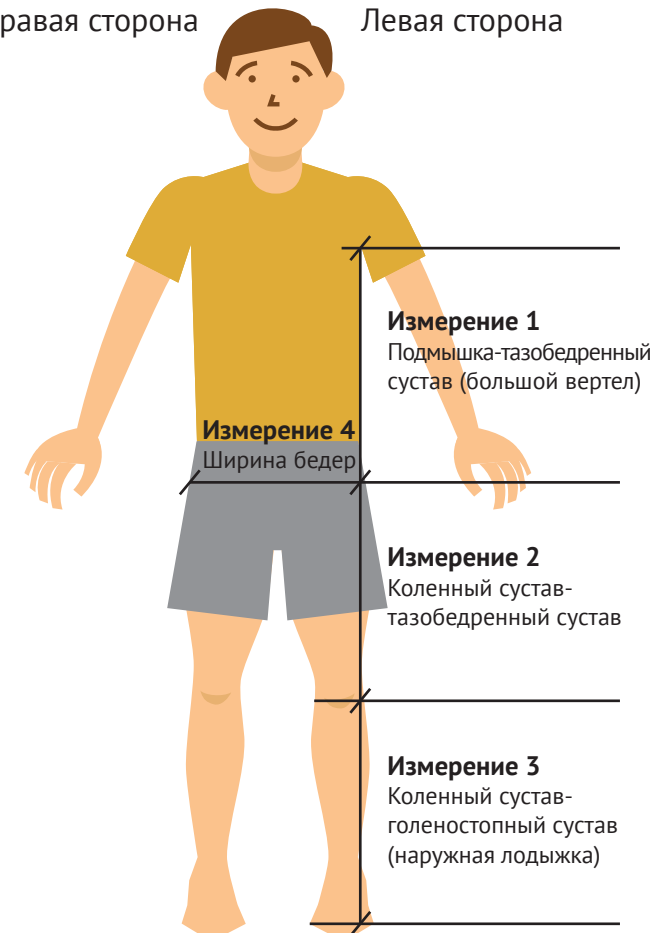

Вопросы о диагнозе:

1. Наличие у пациента укорочения конечности. Пожалуйста опишите (лев./ прав., величина, причина)

2. Наличие контрактур (да / нет)

2. Наличие рекурвации (переразгибания) в коленном суставе (лев./ прав.)

3. Наличие вальгусной деформации (приведения) в коленном суставе (да / нет)

4. Необходимость включить в поставку подголовник (опора для головы) (да / нет)

5. Необходимость включить в поставку боковых ручек-упоров (да / нет)

6. Необходимость включить в поставку столик (да / нет)

Для изготовления оборудования, пожалуйста, направьте заполненную форму эксклюзивному представителю реабилитационного тренажера ЭкзоБот в России ООО «Экзо-технологии» e-mail: info@exo-technology.ru